



Pérola do Planalto

PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDINO DE CAMPOS

SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE

Praça Monsenhor Francisco Van Der Maas N.º 150 - Bairro: Centro

Fone/Fax: (14) 3346-3388 / 3346-3360 / 3346-1626

E-mail: saude@bernardinodecampos.sp.gov.br



PREGÃO ELETRÔNICO N° 11/2022

Processo Administrativo N° 82/2022

ANÁLISE DE DOCUMENTOS E AMOSTRAS

Sr. Pregoeiro, nos servimos do presente para apresentar todas as informações que se seguem abaixo quanto aos produtos ofertados.

ITEM 1

A empresa **CIRÚRGICA UNIÃO LTDA** ofertou o produto **EXUFIBER AG+ - MOLNLYCKE**: a qual podemos comprovar que está em completo desacordo com a solicitação do edital, pois o produto não apresenta nenhuma das solicitações do descritivo conforme demonstraremos abaixo:

SOLICITADO NO EDITAL: COBERTURA ESTÉRIL, não aderente, macia, de cor levemente acinzentada, de material não-tecido, em placa com duas camadas, composta por 100% de fibras de CMC (carboximetilcelulose), concentração de 1,2% a 1,5% de prata iônica, cloreto de benzetônio e EDTA (ácido etilenodiamino tetra-acético). Com costuras de celulose regenerada no sentido horizontal e vertical, pode ser recortada em qualquer direção. Auxilia no tratamento de feridas infectadas ou com risco de infecção. Com a capacidade de absorver grandes quantidades de exsudato, forma um gel macio e coeso que se adapta a superfície da ferida, preenchendo os microcontornos e formando um meio úmido que auxilia na remoção de tecidos desvitalizados (promovendo desbridamento autolítico) e na evolução da cicatrização, combatendo e prevenindo a reformação do biofilme. A absorção é realizada verticalmente e a cobertura faz retenção. Indicada para feridas agudas e crônicas com ou sem presença do biofilme. Tamanho 10 x 10 cm. Ter Registro do produto junto ao Ministério da Saúde (ANVISA). Caixa com 10 unidades. Apresentar junto a proposta: - bula autenticada ou ficha técnica que comprove o cumprimento do descritivo.

A composição do EXUFIBER AG+ - MOLNLYCKE é divergente com a solicitada no edital:

- Não possui dupla camada de fibras 100% de Carboximetilcelulose
- Não possui fibras de celulose
- Não possui prata iônica 1,2%
- Não tem ação anti-biofilme (EDTA e Cloreto de Benzetônio)

CONSIDERAÇÕES TÉCNICAS:

- O produto em fibras de álcool polivinílico (PVA) o que está em completo desacordo com o edital, pois não é solicitado esta característica;
- Dupla camada de Carboximetilcelulose (100%): são resistentes e com grande capacidade de absorção e retenção de exsudato, o produto não possui;
- A camada hidrofílica de contato com a ferida cria um gel coeso em contato com o exsudado da ferida e molçando-se perfeitamente ao seu leito

Jal



PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDINO DE CAMPOS

SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE

Praça Monsenhor Francisco Van Der Maas N.º 150 - Bairro: Centro

Fone/Fax: (14) 3346-3388 / 3346-3360 / 3346-1626



E-mail: saude@bernardinodecampos.sp.gov.br



- Não possui fibras de celulose: esta tem que ter a capacidade de impedir a lateralização do fluido (exsudato para além da borda da ferida)
- 1,2 % de prata iônica: a prata iônica incorporada no curativo mata microrganismos patógenos, tanto planctônicos quanto aqueles presentes no biofilme bacteriano, incluindo bactérias, leveduras e fungos

CONCLUSÃO:

- **DESCCLASSIFICADO**, produto não apresenta a formulação solicitado conforme descritivo do edital;
- **DESCCLASSIFICADO**, não apresentou a carta de credenciamento conforme solicitado no edital;
- **DESCCLASSIFICADO**, por não apresentar o produto em embalagem original e lacrada, entendemos como embalagem original e lacrada o produto dentro de sua caixa inviolada e com a bula do produto.

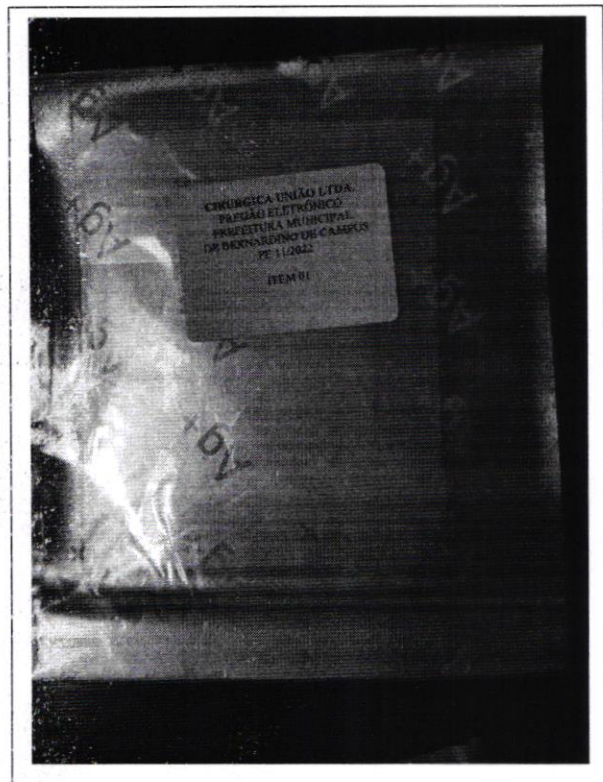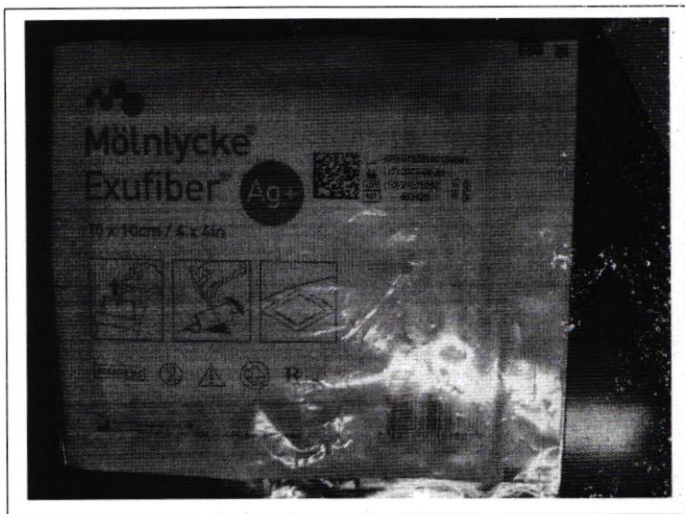

ITEM 2

A empresa **CIRÚRGICA UNIÃO LTDA** ofertou o produto **EXUFIBER AG+ - MOLNLYCKE**: a qual podemos comprovar que está em completo desacordo com a solicitação do edital, pois o produto não apresenta nenhuma das solicitações do descritivo conforme demonstraremos abaixo:

Sol

[Handwritten signature]



Pérola do Planalto

PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDINO DE CAMPOS

SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE

Praça Monsenhor Francisco Van Der Maas N.º 150 - Bairro: Centro

Fone/Fax: (14) 3346-3388 / 3346-3360 / 3346-1626

E-mail: saude@bernardinodecampos.sp.gov.br



SOLICITADO NO EDITAL: COBERTURA ESTÉRIL, não aderente, macia, de cor levemente acinzentada, de material não-tecido, em placa com duas camadas, composta por 100% de fibras de CMC (carboximetilcelulose), concentração de 1,2% a 1,5% de prata iônica, cloreto de benzetônio e EDTA (ácido etilenodiamino tetra-acético). Com costuras de celulose regenerada no sentido horizontal e vertical, pode ser recortada em qualquer direção. Auxilia no tratamento de feridas infectadas ou com risco de infecção. Com a capacidade de absorver grandes quantidades de exsudato, forma um gel macio e coeso que se adapta a superfície da ferida, preenchendo os microcontornos e formando um meio úmido que auxilia na remoção de tecidos desvitalizados (promovendo desbridamento autolítico) e na evolução da cicatrização, combatendo e prevenindo a reformação do biofilme. A absorção é realizada verticalmente e a cobertura faz retenção. Indicada para feridas agudas e crônicas com ou sem presença do biofilme. Tamanho 15 x 15 cm. Ter Registro do produto junto ao Ministério da Saúde (ANVISA). Caixa com 05 unidades. Apresentar junto a proposta: - bula autenticada ou ficha técnica que comprove o cumprimento do descritivo.

A composição do EXUFIBER AG+ - MOLNLYCKE é divergente com a solicitada no edital:

- Não possui dupla camada de fibras 100% de Carboximetilcelulose
- Não possui fibras de celulose
- Não possui prata iônica 1,2%
- Não tem ação anti-biofilme (EDTA e Cloreto de Benzetônio)

CONSIDERAÇÕES TÉCNICAS:

- O produto em fibras de álcool polivinílico (PVA) o que esta em completo desacordo com o edital, pois não é solicitado esta característica;
- Dupla camada de Carboximetilcelulose (100%): são resistentes e com grande capacidade de absorção e retenção de exsudato, o produto não possui;
- A camada hidrofílica de contato com a ferida cria um gel coeso em contato com o exsudado da ferida e moldando-se perfeitamente ao seu leito
- Não possui fibras de celulose: esta tem que ter a capacidade de impedir a lateralização do fluido (exsudato para além da borda da ferida)
- 1,2 % de prata iônica: a prata iônica incorporada no curativo mata microrganismos patógenos, tanto planctônicos quanto aqueles presentes no biofilme bacteriano, incluindo bactérias, leveduras e fungos

CONCLUSÃO:

- **DESCCLASSIFICADO**, produto não apresenta a formulação solicitado conforme descritivo do edital;
- **DESCCLASSIFICADO**, não apresentou a carta de credenciamento conforme solicitado no edital;
- **DESCCLASSIFICADO**, por não apresentar o produto em embalagem original e lacrada, entendemos como embalagem original e lacrada o produto dentro de sua caixa inviolada e com a bula do produto.

Sal





PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDINO DE CAMPOS

SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE

Praça Monsenhor Francisco Van Der Maas N.º 150 - Bairro: Centro

Fone/Fax: (14) 3346-3388 / 3346-3360 / 3346-1626

E-mail: saude@bernardinodecampos.sp.gov.br

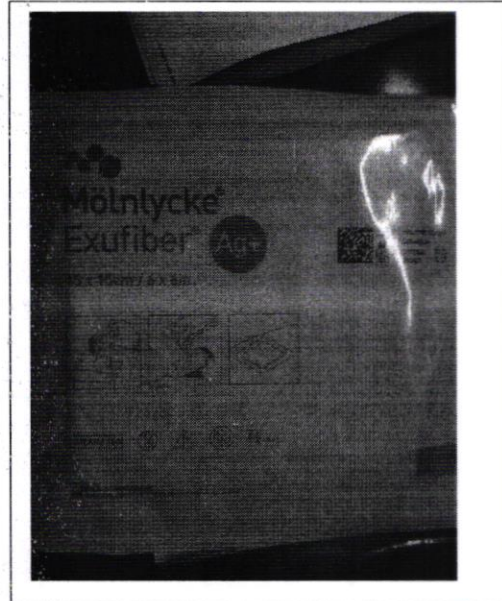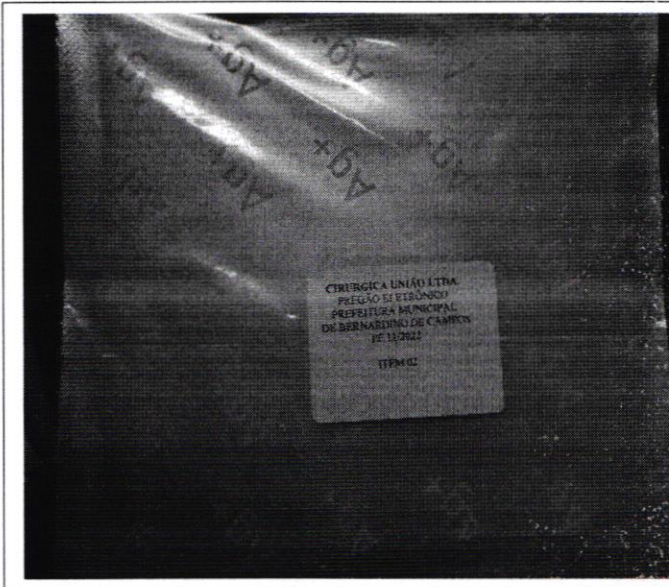

ITEM 3

A empresa **ESFERA MEDICAL EIRELI** ofertou o produto **KENDALL/9252**.

SOLICITADO NO EDITAL: HIDROGEL TRANSPARENTE/INCOLOR, produto não estéril, composto por água purificada, ácido bórico e carboximetilcelulose sódica e alginato de cálcio e sódio, trietanolamina, hidantoína e sorbato de potássio e carbômero 940, que garanta a estabilidade por até 28 dias após aberto. Hidroativo e absorvente, hidrata a ferida e agiliza o debridamento autolítico do tecido necrótico. O produto não pode ter contra-indicação em qualquer tipo de feridas em bula. Tubo de 85g com tampa flip-top. Caixa com 12 tubos. Deverá constar número de lote, prazo de validade e registro no Ministério da Saúde. Apresentar junto a proposta: - bula autenticada ou ficha técnica que comprove o cumprimento do descritivo.

OBS: A empresa não apresentou amostra para o produto conforme constante na solicitação.

CONCLUSÃO: Produto **DECLASSIFICADO** por não apresentar amostra conforme solicitado.

ITEM 4

OBSERVAÇÃO: A mesma empresa ofertou esse produto na licitação do ano anterior e nós da equipe técnica emitimos o laudo conclusivo que o mesmo não atendia a nossa necessidade, a empresa utilizou de seu direito a recurso e nós mantivemos a decisão com argumentações robustas para mantermos nosso parecer ao qual utilizaremos novamente para desclassifica-los.

Gal

[Handwritten signatures]



Pérola do Planalto

PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDINO DE CAMPOS

SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE

Praça Monsenhor Francisco Van Der Maas N.º 150 - Bairro: Centro

Fone/Fax: (14) 3346-3388 / 3346-3360 / 3346-1626

E-mail: saude@bernardinodecampos.sp.gov.br



A empresa **CIRÚRGICA UNIÃO LTDA** ofertou o produto **DERMACURE PLUS BOTA DE UNNA**: a qual podemos comprovar que está em descordo com a solicitação do edital, demonstraremos abaixo:

SOLICITADO NO EDITAL: Curativo Bota de Unna - Curativo bota de unna, composto por bandagem elástica lateral, impregnada com pasta composta por glicerina, óxido de zinco, óleo de rícino, petrolato branco, água, acácia, trama com algodão e poliéster, com costura de reforço nas laterais, promovendo o acabamento da trama. Que tenha os emolientes distribuídos em toda sua extensão, com umidade homogênea. Indicado para tratamento ambulatorial de úlcera venosa e edema linfático dos membros inferiores, podendo permanecer por até 7 dias. Tamanho aproximado em 10,20 cm de largura x 9,14 m de comprimento. CLASSE DE RISCO III. Apresentar junto a proposta: - bula autenticada ou ficha técnica que comprove o cumprimento do descritivo.

A composição do DERMACURE PLUS BOTA DE UNNA é divergente com a solicitada no edital:

- Não possui água
- Medida divergente tamanho: 10,20cmX 9,20 m;
- Bandagem composta por 70 % de poliéster e 30% de algodão, Acacia, glicerina, óleo de castor, petrolato branco, polietileno, 10 % de óxido de zinco, óleo mineral.

CONSIDERAÇÕES TÉCNICAS:

- **Solicitamos que este tipo de produto possua CLASSIFICAÇÃO DE RISCO III em seu registro na ANVISA/MS, porém o produto ofertado pela empresa possui CLASSE DE RISCO II;**
- As bandagens com muito curta elasticidade, proporcionam uma terapia que se ajusta aos contornos do membro, propiciando contenção efetiva ao longo do tempo de permanência (até 7 dias) e sem garroteamento e lesões adicionais devido à bandagem. Junto à pasta, proporcionam uma condição favorável à redução do edema no tratamento da úlcera venosa.
- Glicerina potencializa a capacidade de manutenção da hidratação da pele e tem ações antissépticas.
- Óxido de Zinco é um adstringente e antisséptico que exerce ação suavizante, cicatrizante e protetora da pele.
- A água é fundamental para manter à umidade homogênea, manter umectação, hidratação, controle da carga microbiana na epiderme e capacidade de não enrijecimento da bandagem.

CONCLUSÃO:

- **DESCCLASSIFICADO**, produto não apresenta a formulação solicitado conforme descritivo do edital;
- **DESCCLASSIFICADO**, não apresentou a carta de credenciamento conforme solicitado no edital.

Gal





PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDINO DE CAMPOS

SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE

Praça Monsenhor Francisco Van Der Maas N.º 150 - Bairro: Centro

Fone/Fax: (14) 3346-3388 / 3346-3360 / 3346-1626

E-mail: saude@bernardinodecampos.sp.gov.br

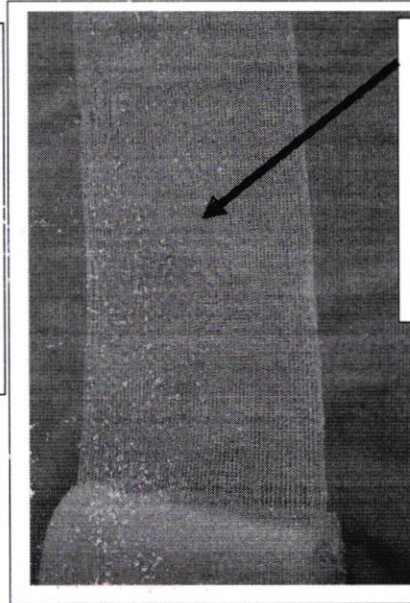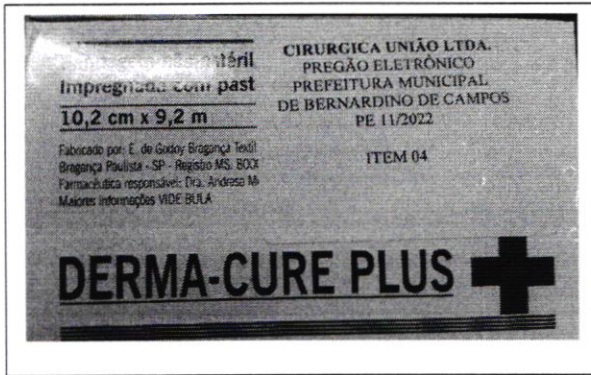

É possível verificar que o produto não possui as costuras de reforço solicitada em edital e emolientes distribuídos em toda sua extensão, com umidade homogênea.

ITEM 5

A empresa **SOQUIMICA LABORATORIOS LTDA** ofertou o produto **AQUACEL FOAM AG**:

SOLICITADO NO EDITAL: CURATIVO ESTÉRIL DE ESPUMA, constituído por uma camada externa impermeável de filme de poliuretano com barreira viral e bacteriana que controla a transmissão de vapor da umidade proveniente do exsudato absorvido pelo curativo e uma almofada central com camadas absorventes. A almofada central absorvente é composta por uma camada de espuma de poliuretano e uma camada em contato com o leito da ferida de 100% fibras de carboximetilcelulose com 1,2% de prata iônica. Sem bordas de adesivo. Indicado como curativo primário ou secundário. Tamanho 10X10cm. Caixa com 10 unidades. Deverá constar número de lote, prazo de validade e registro no Ministério da Saúde. Apresentar junto a proposta: - bula autenticada ou ficha técnica que comprove o cumprimento do descritivo.

A composição do **AQUACEL FOAM AG** esta conformidade com o edital:

CONSIDERAÇÕES TÉCNICAS:

- Camada superior impermeável permite a evaporação do excesso de umidade enquanto protege contra a penetração viral / bacteriana;
- Uma almofada de espuma macia e absorvente para melhorar o conforto do paciente e absorver o excesso de fluido;
- 1,2 % de prata iônica: a prata iônica incorporada no curativo mata microrganismos patógenos, tanto planctônicos quanto aqueles presentes no biofilme bacteriano, incluindo bactérias, leveduras e fungos.

Sal

AS



Pérola do Planalto

PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDINO DE CAMPOS

SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE

Praça Monsenhor Francisco Van Der Maas N.º 150 - Bairro: Centro

Fone/Fax: (14) 3346-3388 / 3346-3360 / 3346-1626

E-mail: saude@bernardinodecampos.sp.gov.br



CONCLUSÃO: Produto **CLASSIFICADO** por estar em conformidade com o edital.

ITEM 6

A empresa **ESFERA MEDICAL EIRELI** ofertou o produto **Kendall / Oferecemos espuma com PHMB, 15X15/55566AMD**.

SOLICITADO NO EDITAL: CURATIVO ESTÉRIL DE ESPUMA, constituído por uma camada externa impermeável de filme de poliuretano com barreira viral e bacteriana que controla a transmissão de vapor da umidade proveniente do exsudato absorvido pelo curativo e uma almofada central com camadas absorventes. A almofada central absorvente é composta por uma camada de espuma de poliuretano e uma camada em contato com o leito da ferida de 100% fibras de carboximetilcelulose com 1,2% de prata iônica. Sem bordas de adesivo. Indicado como curativo primário ou secundário. Tamanho 15 X 15 cm. Caixa com 05 unidades. Deverá constar número de lote, prazo de validade e registro no Ministério da Saúde. Apresentar junto a proposta: - bula autenticada ou ficha técnica que comprove o cumprimento do descritivo.

OBS: A empresa não apresentou amostra para o produto conforme constante na solicitação.

CONCLUSÃO: Produto **DESCLASSIFICADO** por não apresentar amostra conforme solicitado.

ITEM 7

A empresa **CIRÚRGICA UNIÃO LTDA** ofertou o produto **MEPILEX BORDER SACRUM**: a qual podemos comprovar que está em desacordo com a solicitação do edital, demonstraremos abaixo:

SOLICITADO NO EDITAL: CURATIVO ESTÉRIL, DE ESPUMA, **multicamadas**, composto também por uma camada de fibras de carboximetilcelulose sódica (sem adição de outras fibras) que ajudam a manter um microclima ideal na pele em risco, absorvendo e bloqueando o excesso de umidade. Diminui os fatores de risco extrínsecos para o desenvolvimento da lesão por pressão (fricção, pressão, cisalhamento e microclima). Tem baixo coeficiente de fricção e barreira bacteriana e viral com alta taxa de transmissão de vapor e umidade. Em formato sacral, com adesivo de silicone perfurado em contato com a pele. Tamanho: 20 x 16,9cm. **Caixa com 05 unidades**. Apresentar bula autenticada que comprove o cumprimento do descritivo.

A composição do **MEPILEX BORDER SACRUM - MOLNLYCKE** é divergente com a solicitada no edital:

- Não possui fibras de Carboximetilcelulose
- Possui Carvão ativado que não é solicitado em edital;

Gal



PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDINO DE CAMPOS
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE

Praça Monsenhor Francisco Van Der Maas N.º 150 - Bairro: Centro
Fone/Fax: (14) 3346-3388 / 3346-3360 / 3346-1626
E-mail: saude@bernardinodecampos.sp.gov.br



- Não possui adesivo de silicone microperfurado que vai em contato direto com a pele;
- Possui sultato de prata que não é solicitado em edital, e nesse caso, como o curativo é para a prevenção e não tratamento da lesão não há necessidade desse composto, por isso não solicitamos e não queremos a prata neste item;
- Possui poliéster e algodão em sua composição, coisa que não solicitamos também na composição do produto.

CONCLUSÃO:

- **DESCCLASSIFICADO**, produto não apresenta a formulação solicitado conforme descritivo do edital;
- **DESCCLASSIFICADO**, não apresentou a carta de credenciamento conforme solicitado no edital;
- **DESCCLASSIFICADO**, por não apresentar o produto em embalagem original e lacrada, entendemos como embalagem original e lacrada o produto dentro de sua caixa inviolada e com a bula do produto.

ITEM 8

A empresa **CIRÚRGICA UNIÃO LTDA** ofertou o produto **SETOPRESS**: a qual podemos comprovar que está em desacordo com a solicitação do edital, demonstraremos abaixo:

SOLICITADO NO EDITAL: Atadura elástica porosa; reutilizável de cor cru, medindo no mínimo 10 cm x 3m; a base de algodão/viscose, nylon e poliuretano elastano; com propriedade de compressão com indicação de limite de compressão retangulares; enrolada de forma contínua e uniforme; embalagem individual, em material que garanta a integridade do produto apresentação do produto deverá obedecer a legislação atual vigente. Lavável por no mínimo, 20 vezes. Ter Registro no ministério da Saúde (ANVISA). Apresentar junto a proposta: - bula autenticada ou ficha técnica que comprove o cumprimento do descritivo.

A composição da SETOPRESS é divergente com a solicitada no edital:

- É fabricada em Nylon;
- **Não pode ser reutilizável no caso de contato com fluidos corporais**, o que se torna totalmente inviável já que uma das maiores utilizações é para úlceras venosas, onde possui a drenagem de grande quantidade de fluidos corporais

CONSIDERAÇÕES TÉCNICAS:

- Algodão/viscose, nylon e poliuretano elastano garante bandagem absorvente e macia, auxilia na distribuição da compressão graduada e protege a pele contra qualquer extravasamento de exsudato a partir do curativo primário;

Sal






PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDINO DE CAMPOS

SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE

Praça Monsenhor Francisco Van Der Maas N.º 150 - Bairro: Centro
Fone/Fax: (14) 3346-3388 / 3346-3360 / 3346-1626
E-mail: saude@bernardinodecampos.sp.gov.br



- Guia visual com indicador central e indicador de tensão: permite o posicionamento da bandagem em 50% para cada volta, seguindo a técnica de aplicação em espiral garantindo uma compressão adequada usando retângulo ou quadrado, de acordo com a medição do diâmetro do perímetro do tornozelo;
- Reutilizável: sua composição permite reutilização (lavagens) até 20 vezes mantendo a elasticidade;

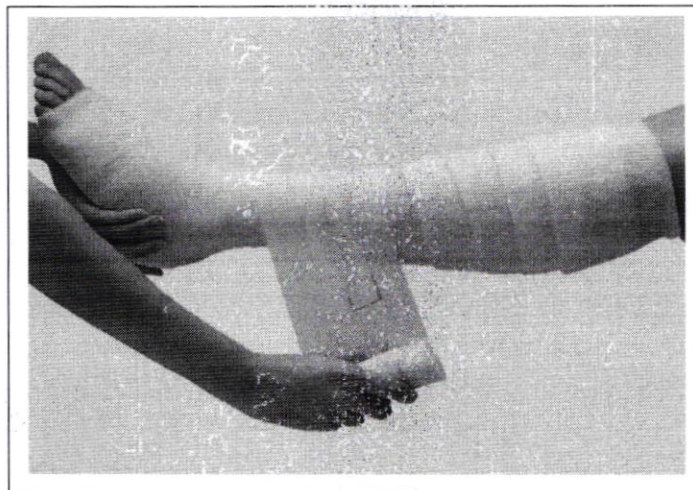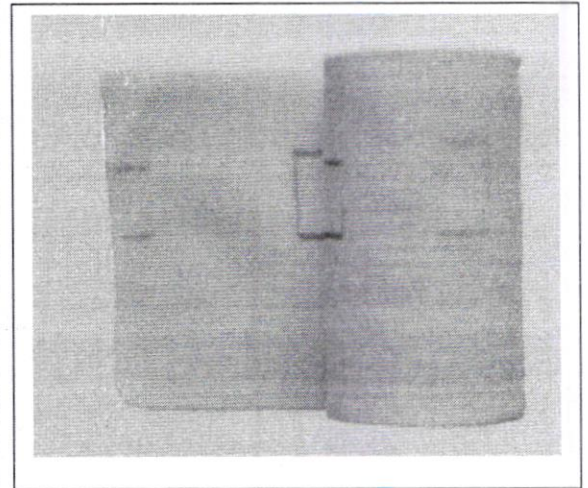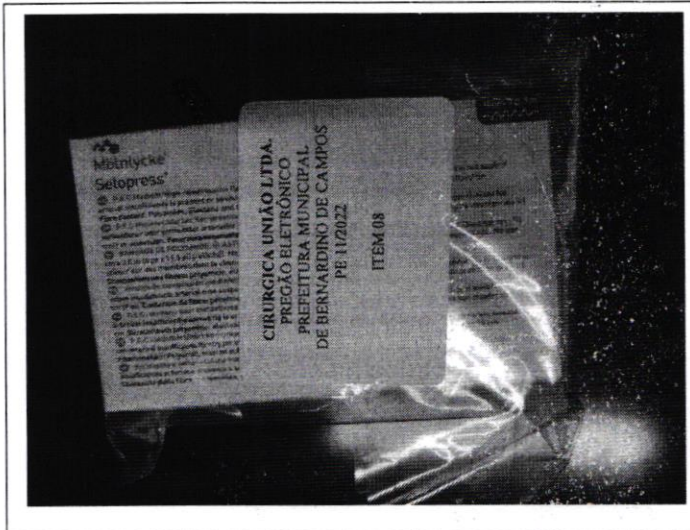

CONCLUSÃO:

- **DECLASSIFICADO**, produto não apresenta a formulação solicitada conforme descritivo do edital;
- **DECLASSIFICADO**, não apresentou a carta de credenciamento conforme solicitado no edital;

Sal

Handwritten signature



Pérola do Planalto

PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDINO DE CAMPOS

SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE

Praça Monsenhor Francisco Van Der Maas N.º 150 - Bairro: Centro

Fone/Fax: (14) 3346-3388 / 3346-3360 / 3346-1626

E-mail: saude@bernardinodecampos.sp.gov.br



ITEM 9

A empresa **CIRÚRGICA UNIÃO LTDA** ofertou o produto **DEBRIGEL ALG Ca 85g**: a qual podemos comprovar que está em descordo com a solicitação do edital, demonstraremos abaixo:

SOLICITADO NO EDITAL: GEL VISCOSO COM PECTINA E CARBOXIMETILCELULOSE SODICA, estéril, hidratante e absorvente composto por hidrocoloides naturais, acrescido de propilenoglicol num excipiente aquoso. Auxilia no desbridamento de feridas com tecido inviável, e cria um ambiente úmido, que favorece a cicatrização. Tubo de alumínio com 15 gr., que permite o total aproveitamento do conteúdo, com tampa perfurante e anel de proteção. Deverá constar número de lote, prazo de validade e registro no Ministério da Saúde. Caixa com 10 unidades. Apresentar junto a proposta: - bula autenticada ou ficha técnica que comprove o cumprimento do descritivo.

A composição do DEBRIGEL Alg Ca 85g é divergente com a solicitada no edital:

- É solicitado que o produto seja estéril, o item ofertado não é estéril;
- É solicitado que o produto seja de 15g e o produto ofertado é de 85g;

CONSIDERAÇÕES TÉCNICAS:

- Pectina e Carboximetilcelulose auxilia na absorção de umidade, auxilia a regeneração da pele;
- Estéril decorrente de seu uso em pacientes que possuem algum tipo de alergia a componentes preservantes;



CONCLUSÃO:

- **DESCLASSIFICADO**, produto não apresenta a formulação solicitado conforme descritivo do edital;

Gal

Ph e



Pérola do Planalto

PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDINO DE CAMPOS

SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE

Praça Monsenhor Francisco Van Der Maas N.º 150 - Bairro: Centro

Fone/Fax: (14) 3346-3388 / 3346-3360 / 3346-1626

E-mail: saude@bernardinodecampos.sp.gov.br



- **DESCLASSIFICADO**, não apresentou a carta de credenciamento conforme solicitado no edital;

ITEM 10

A empresa **SOQUIMICA LABORATORIOS LTDA** ofertou o produto **DUODERM SIGNAL**:

SOLICITADO NO EDITAL: CURATIVO HIDROCOLÓIDE ADESIVO DE BAIXO PERFIL, de bordas delgadas, estéril, mais fino nas bordas do que no centro para reduzir a ocorrência de enrolamentos durante o uso. Composto por uma camada interna que contém 3 hidrocolóides (gelatina, pectina e carboximetilcelulose), poliisobutileno e polímeros elastoméricos para controle da formação do gel. Possui uma linha demarcada indicadora do momento de troca, devendo ser trocado quando o gel atingir esta linha pontilhada. A camada externa de poliuretano oferece barreira para bactérias, vírus e outras contaminações externas. Apresentação em placas de 20 cm x 20 cm, **Caixa com 05 unidades**. Deverá constar número de lote, prazo de validade e registro no Ministério da Saúde. Apresentar junto a proposta: - bula autenticada ou ficha técnica que comprove o cumprimento do descritivo.

A composição do **DUODERM SIGNAL** está de acordo com o solicitado:

- Possui os 3 hidrocolóides conforme solicitado;
- Possui barreira viral e bacteriana comprovada em bula;
- Possui linha de demarcação conforme solicitado.

CONSIDERAÇÕES TÉCNICAS:

- 3 hidrocolóides garante melhor absorção do exsudato;
- Barreira bacteriana e viral garante proteção contra microorganismos e outros agentes externos;
- Linha demarcatória garante troca do curativo quando saturado;

CONCLUSÃO: Produto **CLASSIFICADO** por estar em conformidade com o edital.

ITEM 11

A empresa **SÓ QUIMICA LABORATÓRIOS LTDA** ofertou o produto **STOMAHESIVE PÓ - CONVATEC** a qual podemos comprovar que:

SOLICITADO NO EDITAL: PÓ PROTETOR QUE ABSORVE A UMIDADE DA PELE PERIESTOMAL LESIONADA, formando uma barreira protetora que auxilia na Regeneração da pele melhora a fixação dos dispositivos para estomia. Composto por gelatina, pectina, carboximetilcelulose sódica. Embalagem com 28,3 gramas. Ter Registro do produto junto ao Ministério da Saúde (ANVISA). Apresentar junto a

Sal



Pérola do Planalto

PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDINO DE CAMPOS

SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE

Praça Monsenhor Francisco Van Der Maas N.º 150 - Bairro: Centro

Fone/Fax: (14) 3346-3388 / 3346-3360 / 3346-1626

E-mail: saude@bernardinodecampos.sp.gov.br



proposta: - bula autenticada ou ficha técnica que comprove o cumprimento do descritivo.

A composição do STOMAHESIVE PÓ - CONVATEC é compatível com a solicitada no edital:

- Está em conformidade com o descritivo atendendo plenamente o solicitado

CONCLUSÃO: Produto **CLASSIFICADO** por estar em conformidade com o edital.

ITEM 12

A empresa **SÓ QUÍMICA LABORATÓRIOS LTDA** ofertou o produto **STOMAHESIVE PASTA - CONVATEC** a qual podemos comprovar que:

SOLICITADO NO EDITAL: **BARREIRA PROTETORA DE PELE EM PASTA**, maleável para selar e nivelar as irregularidades da pele peristomal. Tubo de 56,7 gramas. Composta por Gelatina, pectina, carboximetilcelulose sódica, etanol, éster monobutílico do copolímero de éter metilvinílico, anidrido maleico, tris-12-hidroxiestearato de glicerila e triacetato de glicerila. Ter Registro do produto junto ao Ministério da Saúde (ANVISA). Apresentar junto a proposta: - bula autenticada ou ficha técnica que comprove o cumprimento do descritivo.

A composição do STOMAHESIVE PASTA - CONVATEC é compatível com a solicitada no edital:

- Está em conformidade com o descritivo atendendo plenamente o solicitado

CONCLUSÃO: Produto **CLASSIFICADO** por estar em conformidade com o edital.

ITEM 13

A empresa **SÓ QUÍMICA LABORATÓRIOS LTDA** ofertou o produto **CINTO PARA BOLSA DE COLOSTOMIA - CONVATEC** a qual podemos comprovar que:

SOLICITADO NO EDITAL: **CINTO PARA SUPORTE DE BOLSA DE OSTOMIA, USO ADULTO:** Cinto ajustável para estomia composto de nylon elástico branco, ligado com fita 100% algodão e costurado com fio de poliéster. Deverá possuir fivela para ajuste e fecho de plástico. O Cinto deverá se alargar até 160 cm. Caixa com 1 unidade. Ter Registro do produto junto ao Ministério da Saúde (ANVISA). Apresentar junto a proposta: - bula autenticada ou ficha técnica que comprove o cumprimento do descritivo.

A composição do CINTO PARA BOLSA DE COLOSTOMIA - CONVATEC é compatível com a solicitada no edital:

- Está em conformidade com o descritivo atendendo plenamente o solicitado

CONCLUSÃO: Produto **CLASSIFICADO** por estar em conformidade com o edital.

Sal



Pérola do Planalto

PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDINO DE CAMPOS

SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE

Praça Monsenhor Francisco Van Der Maas N.º 150 - Bairro: Centro

Fone/Fax: (14) 3346-3388 / 3346-3360 / 3346-1626

E-mail: saude@bernardinodecampos.sp.gov.br



ITEM 14

A empresa **CIRÚRGICA UNIÃO LTDA** ofertou o produto **VUELO**: a qual podemos comprovar que está em desacordo com a solicitação do edital, demonstraremos abaixo:


SOLICITADO NO EDITAL: BARREIRA PROTETORA SPRAY: Líquido composto por base de silicone (dixiloxane, Zanthalene e sílica trimetilada) formador de filme protetor flexível sobre a pele contra os efeitos deteriorantes dos efluentes corporais, enzimas e adesivos, sem deixar resíduos livre de álcool com propriedade anti-prurido, calmante da pele, ajudando a reduzir a dor e coceira ao longo do tempo. Produtos sem impactos ambientais, dentro das normas internacionais de restrição de substâncias. Embalado individualmente em frasco contendo 28 ml. Ter Registro do produto junto ao Ministério da Saúde (ANVISA). Apresentar junto a proposta: - bula autenticada ou ficha técnica que comprove o cumprimento do descritivo.

A composição do VUELO é divergente com a solicitada no edital:

Disiloxane, Trimethylsiloxysilicate, isododecane, acrylates, polytrimethylsiloxy methacrylate copolymer, dimethicone, trimethylsiloxysilicate. Frasco 28 ml

É solicitado no descritivo Barreira protetor spray, com líquido composto por dixiloxane, Zanthalene e sílica trimetilada, o produto VUELO tem associação aos compostos 100% silicone de:

- Acrylates (acrilatos) e methacrylate copolymer (Copolímeros de metacrilato);

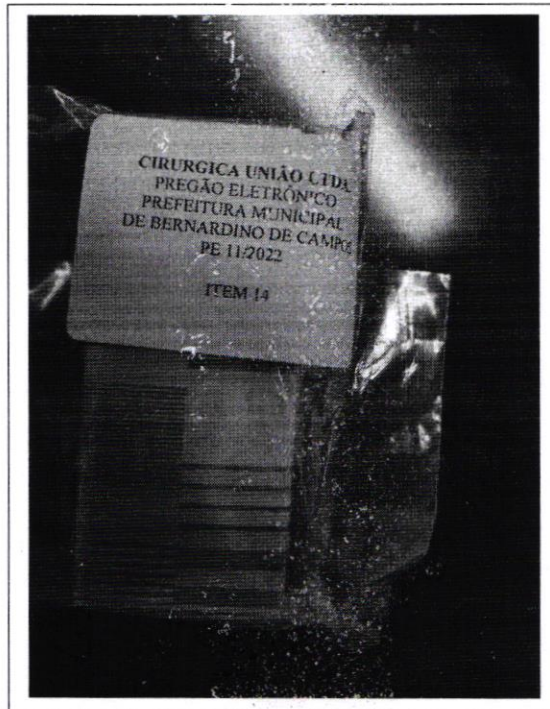

CONCLUSÃO:

- **DESCLASSIFICADO**, produto não apresenta a formulação solicitado conforme descritivo do edital;

Val

AS R



PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDINO DE CAMPOS

SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE

Praça Monsenhor Francisco Van Der Maas N.º 150 - Bairro: Centro

Fone/Fax: (14) 3346-3388 / 3346-3360 / 3346-1626

E-mail: saude@bernardinodecampos.sp.gov.br



- **DESCCLASSIFICADO**, não apresentou a carta de credenciamento conforme solicitado no edital;


ITEM 15

A empresa **CIRURGICA UNIÃO LTDA** ofertou o produto **LIMPCOLL SPRAY REMOVEDOR 50ML** a qual podemos comprovar que:

SOLICITADO NO EDITAL: REMOVEDOR DE ADESIVO: Líquido composto por 100% silicone (dixiloxane, octamethyltrisiloxano), de uso tópico, removedor de qualquer tipo de adesivo, como equipamentos de estomia (bases adesivas e adjuvantes), fitas adesivas, películas, hidrocolóides e todos os curativos que permaneçam aderidos à pele, livre de álcool e fragrâncias, atraumático. Produto sem impactos ambientais, dentro das normas internacionais de restrição de substâncias. Embalado individualmente em frasco contendo 50ml, spray que permite uma pulverização contínua de 360 graus e o máximo de aproveitamento do conteúdo da embalagem, sem que o aerossol deixe resíduo. Não estéril. Ter Registro do produto junto ao Ministério da Saúde (ANVISA). Apresentar junto a proposta: - bula autenticada ou ficha técnica que comprove o cumprimento do descritivo.

A composição do SPRAY LIMPCOLL é divergente do solicitado no edital:

- C11-13 ISOPARAFFIN;
- CAPRYLIC/CAPRIC TRIGLYCERIDE,
- PARAFFINUMLIQUIDUM, CYCLOPENTASILOXANE.
- O edital solicita que o produto tenha possibilidade de utilização em 360º para o melhor aproveitamento, mas este produto não faz.

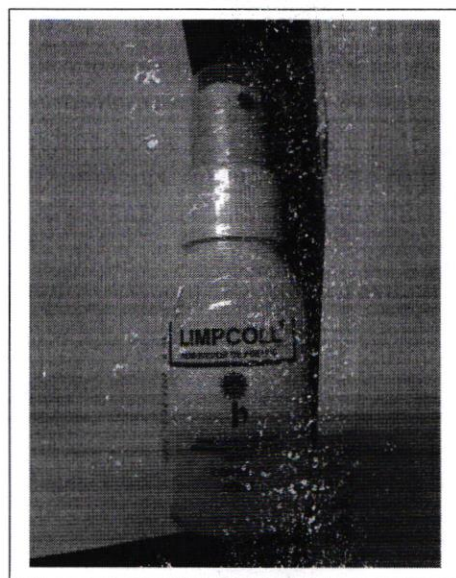

CONCLUSÃO:

Sal

[Handwritten signature]



Pérola do Planalto

PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDINO DE CAMPOS

SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE

Praça Monsenhor Francisco Van Der Maas N.º 150 - Bairro: Centro

Fone/Fax: (14) 3346-3388 / 3346-3360 / 3346-1626

E-mail: saude@bernardinodecampos.sp.gov.br



SAÚDE
MAIS PERTO DE VOCÊ

- **DESCCLASSIFICADO**, produto não apresenta a formulação solicitado conforme descritivo do edital;
- **DESCCLASSIFICADO**, não apresentou a carta de credenciamento conforme solicitado no edital;
- **OBSERVAÇÃO**, a empresa não rotulou o produto com a etiqueta identificando as informações do pregão, numero do item.

ITEM 16

A empresa **CIRÚRGICA UNIÃO LTDA** ofertou o produto **DERMILON – REMOVEDOR DE ADESIVO EM LENÇO** a qual podemos comprovar que está em desacordo com o edital:

SOLICITADO NO EDITAL: REMOVEDOR DE ADESIVO EM LENÇO: Lenço umedecido por composto 100% silicone (dixiloxane, octamethyltrisiloxano), de uso tópico, removedor de qualquer tipo de adesivo, como equipamentos de estomia (bases adesivas e adjuvantes), fitas adesivas, películas, hidrocolóides e todos os curativos que permaneçam aderidos à pele, livre de álcool e fragrâncias, atraumático. Produto sem impactos ambientais, dentro das normas internacionais de restrição de substâncias. Embalado individualmente. Não estéril. **Caixa com 30 unidades.** Ter Registro do produto junto ao Ministério da Saúde (ANVISA). Apresentar junto a proposta: - bula autenticada ou ficha técnica que comprove o cumprimento do descritivo.

CONCLUSÃO:

- **DESCCLASSIFICADO**, a empresa não apresentou amostra do produto conforme solicitação do edital.

ITEM 17

A empresa **SÓ QUÍMICA LABORATÓRIOS LTDA** ofertou o produto **BOLSA PARA ESTOMA INTESTINAL CONVEXA - CONVATEC** para o item do pregão a qual podemos comprovar que:

SOLICITADO NO EDITAL: BOLSA PARA ESTOMA INTESTINAL CONVEXA: bolsa para estoma intestinal convexa, com barreira. Protetora de pele flexível composta por dois hidrocolóides (carboximetilcelulose sódica e pectina) e polisobutileno, borda de apoio delgada (1cm) e flexível com a mesma composição da barreira, recortável de 20-57 mm. Convexidade de 7 mm de profundidade e diâmetro de pressão de 60 mm. Dupla camada de filme plástico interno com fenda em “s” e filtro com sistema de proteção contra umidade na parte superior da bolsa. Painel de conforto bilateral composto por Polietileno linear de baixa densidade (lhdpe) e janela de visualização para inspeção do estoma, fechamento por intertravamento de estruturas plásticas, de fácil higienização, canal de drenagem com tiras de Polipropileno e aba para fechamento e auxílio para drenagem. Ter Registro na ANVISA, adquirir múltiplos de

Sal



Pérola do Planalto

PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDINO DE CAMPOS
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE

Praça Monsenhor Francisco Van Der Maas N.º 150 - Bairro: Centro
Fone/Fax: (14) 3346-3388 / 3346-3360 / 3346-1626
E-mail: saude@bernardinodecampos.sp.gov.br



10 unidades. Apresentar junto a proposta: - bula autenticada ou ficha técnica que comprove o cumprimento do descritivo.

A composição da BOLSA PARA ESTOMA INTESTINAL CONVEXA - CONVATEC é compatível com a solicitada no edital:

- Está em conformidade com o descritivo atendendo plenamente o solicitado

CONCLUSÃO: Produto **CLASSIFICADO** por estar em conformidade com o edital.

ITEM 18

A empresa **SÓ QUÍMICA LABORATÓRIOS LTDA** ofertou o produto **BOLSA COLETORA DE UMA PEÇA - CONVATEC** para o item do pregão a qual podemos comprovar que:

SOLICITADO NO EDITAL: **BOLSA COLETORA DE UMA PEÇA PARA COLOSTOMIA E ILEOSTOMIA** Equipamento para estoma intestinal; drenável, bolsa opaca; com plástico macio, atóxico e hipoalergênico, confeccionada em películas plásticas de EVA e PVDC; revestimento, e tela plástica microperfurada; resina sintética composta por três hidrocolóides (carboximetilcelulose sódica, pectina e gelatina); flexível, recorte inicial 19mm e final 64 mm; 1 peça; com adesivo microporoso hipoalergênico, caixa com 10 unidades. Ter Registro do produto junto ao Ministério da Saúde (ANVISA). Apresentar junto a proposta: - bula autenticada ou ficha técnica que comprove o cumprimento do descritivo.

A composição da BOLSA COLETORA DE UMA PEÇA - CONVATEC é compatível com a solicitada no edital:

- Está em conformidade com o descritivo atendendo plenamente o solicitado

CONCLUSÃO: Produto **CLASSIFICADO** por estar em conformidade com o edital.

ITEM 19

A empresa **SÓ QUÍMICA LABORATÓRIOS LTDA** ofertou o produto **KIT PLACA E BOLSA 2 PEÇAS 45mm - CONVATEC** para o item do pregão a qual podemos comprovar que:

SOLICITADO NO EDITAL: **KIT PLACA E BOLSA 2 PEÇAS DE 45 MM, PARA COLOSTOMIA/ILEOSTOMIA** confeccionada com 3 películas plásticas, constituída por EVA E PVDC, drenável; com plástico macio, atóxico e hipoalergênico; opaca, com tela microperfurada; com pressão abdominal; 8 pontos de fixação. Placa plana de resina sintética composta por gelatina, pectina, carboximetilcelulose sódica e polímeros elastoméricos; recortável de 13 mm até 45 mm; com adesivo microporoso de reforço. Ter Registro do produto junto ao Ministério da Saúde (ANVISA). Apresentar junto a proposta: - bula autenticada ou ficha técnica que comprove o cumprimento do descritivo.

Gal



Pérola do Planalto

PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDINO DE CAMPOS

SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE

Praça Monsenhor Francisco Van Der Maas N.º 150 - Bairro: Centro

Fone/Fax: (14) 3346-3388 / 3346-3360 / 3346-1626

E-mail: saude@bernardinodecampos.sp.gov.br



A composição do KIT PLACA E BOLSA 2 PEÇAS 45mm - CONVATEC é compatível com a solicitada no edital:

- Está em conformidade com o descritivo atendendo plenamente o solicitado

CONCLUSÃO: Produto **CLASSIFICADO** por estar em conformidade com o edital.

ITEM 20

A empresa **SÓ QUÍMICA LABORATÓRIOS LTDA** ofertou o produto KIT PLACA E BOLSA 2 PEÇAS 45mm (13-22) - CONVATEC para o item do pregão a qual podemos comprovar que:

SOLICITADO NO EDITAL: KIT PLACA E BOLSA PARA ESTOMA INTESTINAL CONVEXA 2 PEÇAS 45MM (13-22) MOLDÁVEL: drenável, com plástico macio, atóxico e hipoalergênico, opaca, com oito pontos de fixação, barreira Convexa moldável, permitindo que a abertura para encaixe do estoma seja moldada com os dedos. Placa de resina com 3 camadas, superior e inferior (contato com a pele) composta por gelatina, pectina, carboximetilcelulose e polímeros elastoméricos, e a camada média por película de polietileno impermeável a líquidos. Placa moldável que adapta a estomas regulares e irregulares, com diâmetro entre 13-22mm sem utilização de acessórios para recorte, flange 45 mm com pressão abdominal e 8 pontos de fixação, composta de 2 peças para estoma intestinal. Ter Registro do produto junto ao Ministério da Saúde (ANVISA). Apresentar junto a proposta: - bula autenticada ou ficha técnica que comprove o cumprimento do descritivo.

A composição do KIT PLACA E BOLSA 2 PEÇAS 45mm (13-22) - CONVATEC é compatível com a solicitada no edital:

- Está em conformidade com o descritivo atendendo plenamente o solicitado

CONCLUSÃO: Produto **CLASSIFICADO** por estar em conformidade com o edital.

ITEM 21

A empresa **SÓ QUÍMICA LABORATÓRIOS LTDA** ofertou o produto KIT PLACA E BOLSA 2 PEÇAS 45mm (22-33) - CONVATEC para o item do pregão a qual podemos comprovar que:

SOLICITADO NO EDITAL: KIT PLACA E BOLSA PARA ESTOMA INTESTINAL CONVEXA 2 PEÇAS 45MM (22-33) MOLDÁVEL: drenável, com plástico macio, atóxico e hipoalergênico, opaca, com oito pontos de fixação, barreira Convexa moldável, permitindo que a abertura para encaixe do estoma seja moldada com os dedos. Placa de resina com 3 camadas, superior e inferior (contato com a pele) composta por gelatina, pectina, carboximetilcelulose e polímeros elastoméricos, e a camada média por película de polietileno impermeável a líquidos. Placa moldável que adapta a estomas regulares e irregulares, com diâmetro entre 22-33mm sem utilização de acessórios para recorte, flange 45 mm com pressão abdominal e 8 pontos de fixação, composta de 2 peças para estoma intestinal. Ter Registro do produto junto ao Ministério

Sal



PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDINO DE CAMPOS
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE

Praça Monsenhor Francisco Van Der Maas N.º 150 - Bairro: Centro
Fone/Fax: (14) 3346-3388 / 3346-3360 / 3346-1626
E-mail: saude@bernardinodecampos.sp.gov.br



da Saúde (ANVISA). Apresentar junto a proposta: - bula autenticada ou ficha técnica que comprove o cumprimento do descritivo.

A composição do KIT PLACA E BOLSA 2 PEÇAS 45mm (22-33) - CONVATEC é compatível com a solicitada no edital:

- Está em conformidade com o descritivo atendendo plenamente o solicitado

CONCLUSÃO: Produto **CLASSIFICADO** por estar em conformidade com o edital.

ITEM 22

A empresa **SÓ QUIMICA LABORATÓRIOS LTDA** ofertou o produto **KIT PLACA E BOLSA 2 PEÇAS 57mm - CONVATEC** a qual podemos comprovar que:

SOLICITADO NO EDITAL: **KIT PLACA E BOLSA 2 PEÇAS DE 57 MM, PARA COLOSTOMIA/ILEOSTOMIA** confeccionada com 3 películas plásticas, constituída por EVA E PVDC, drenável; com plástico macio, atóxico e hipoalérgico; opaca, com tela microperfurada; com pressão abdominal; 8 pontos de fixação. Placa plana de resina sintética composta por gelatina, pectina, carboximetilcelulose sódica e polímeros elastoméricos; recortável de 13 mm até 57 mm; com adesivo microporoso de reforço. Ter Registro do produto junto ao Ministério da Saúde (ANVISA). Apresentar junto a proposta: - bula autenticada ou ficha técnica que comprove o cumprimento do descritivo.

A composição do KIT PLACA E BOLSA 2 PEÇAS 57mm - CONVATEC é compatível com a solicitada no edital:

- Está em conformidade com o descritivo atendendo plenamente o solicitado

CONCLUSÃO: Produto **CLASSIFICADO** por estar em conformidade com o edital.

ITEM 23

A empresa **SÓ QUIMICA LABORATÓRIOS LTDA** ofertou o produto **KIT PLACA E BOLSA 2 PEÇAS 57mm (33-45) CONVEXA - CONVATEC** a qual podemos comprovar que:

SOLICITADO NO EDITAL: **KIT PLACA E BOLSA 2 PEÇAS DE 57 MM (33-45), MOLDÁVEL, CONVEXA, PARA COLOSTOMIA/ILEOSTOMIA** bolsa drenável para ostomia intestinal opaca em plástico macio, atóxico, hipoalérgico, com pressão abdominal, 8 pontos de fixação. Placa de resina superior e inferior composta por gelatina, pectina, carboximetilcelulose e polímeros elastoméricos. Camada intermediária em película de polietileno impermeável a líquidos. Sua placa adapta por pressão a estomas regulares e irregulares com diâmetro de 33 a 45mm. Adesivo microporoso de reforço. Registro na anvisa adquirir múltiplos de 10 unidades. Ter Registro do produto junto ao Ministério da Saúde (ANVISA). Apresentar junto a proposta: - bula autenticada ou ficha técnica que comprove o cumprimento do descritivo.

Sal

Handwritten signature in blue ink.



Pérola do Planalto

PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDINO DE CAMPOS

SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE

Praça Monsenhor Francisco Van Der Maas N.º 150 - Bairro: Centro

Fone/Fax: (14) 3346-3388 / 3346-3360 / 3346-1626

E-mail: saude@bernardinodecampos.sp.gov.br



A composição do KIT PLACA E BOLSA 2 PEÇAS 57mm (33-45) CONVEXA - CONVATEC é compatível com a solicitada no edital:

- Está em conformidade com o descritivo atendendo plenamente o solicitado

CONCLUSÃO: Produto **CLASSIFICADO** por estar em conformidade com o edital.

ITEM 24

A empresa **SÓ QUÍMICA LABORATÓRIOS LTDA** ofertou o produto **SISTEMA BOLSA DE UROSTOMIA 1 PEÇA - CONVATEC** a qual podemos comprovar que:

SOLICITADO NO EDITAL: SISTEMA BOLSA DE UROSTOMIA 1 PEÇA: Bolsa coletora de uma peça para urostomia com base adesiva protetora de pele plana flexível com baixo perfil, recortável, com válvula antirrefluxo e torneira para drenagem; composta por gelatina, pectina, carboximetilcelulose sódica e polímeros elastoméricos e bolsa coletora confeccionada com 2 películas plásticas. Recortável de 19mm a 45mm. Ter Registro do produto junto ao Ministério da Saúde (ANVISA). Apresentar bula autenticada que comprove o cumprimento do descritivo.

A composição do SISTEMA BOLSA DE UROSTOMIA 1 PEÇA - CONVATEC é compatível com a solicitada no edital:

- Está em conformidade com o descritivo atendendo plenamente o solicitado

CONCLUSÃO: Produto **CLASSIFICADO** por estar em conformidade com o edital.

ITEM 25

A empresa **SÓ QUÍMICA LABORATÓRIOS LTDA** ofertou o produto **SISTEMA 2 PEÇAS PARA ESTOMA URINÁRIO 45MM - CONVATEC** a qual podemos comprovar que:

SOLICITADO NO EDITAL: SISTEMA 2 PEÇAS PARA ESTOMA URINÁRIO, BOLSA PARA ESTOMA URINÁRIO 2 PEÇAS, 45 MM, PARA UROSTOMIA confeccionada com 3 películas plásticas, constituída por EVA e PVDC; Drenável; com plástico macio, atóxico e hipoalergênico; com tela microperfurada; com pressão abdominal; 8 pontos de fixação. Placa para ostomia convexa de resina composta por hidrocoloides de gelatina, pectina, carboximetilcelulose sódica; recortável de 13 mm até 45 mm; composta de 2 peças, com base adesivo microporoso. Ter Registro do produto junto ao Ministério da Saúde (ANVISA). Apresentar bula autenticada que comprove o cumprimento do descritivo

A composição do SISTEMA 2 PEÇAS PARA ESTOMA URINÁRIO 45MM - CONVATEC para é compatível com a solicitada no edital:

- Está em conformidade com o descritivo atendendo plenamente o solicitado

CONCLUSÃO: Produto **CLASSIFICADO** por estar em conformidade com o edital.

Sal



Pérola do Planalto

PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDINO DE CAMPOS

SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE

Praça Monsenhor Francisco Van Der Maas N.º 150 - Bairro: Centro

Fone/Fax: (14) 3346-3388 / 3346-3360 / 3346-1626

E-mail: saude@bernardinodecampos.sp.gov.br



SAÚDE
MAIS PERTO DE VOCÊ

ITEM 26

A empresa **SÓ QUÍMICA LABORATÓRIOS LTDA** ofertou o produto **BOLSA PARA ESTOMA INTESTINAL 2 PEÇAS 70MM - CONVATEC** para o item do **pregão** a qual podemos comprovar que:

SOLICITADO NO EDITAL: BOLSA PARA ESTOMA INTESTINAL 2 PEÇAS, 70mm, para colostomia/ileostomia confeccionada com 3 películas plásticas, constituída por eva e pvdc, drenável; com plástico macio, atóxico e hipoalergênico; opaca, com tela microperfurada; com pressão abdominal; 8 pontos de fixação. Placa para estomia de resina sintética composta por gelatina, pectina, carboximetilcelulose sódica e polímeros elastoméricos; recortável de 13 mm até 70 mm; com adesivo microporoso de reforço. Ter Registro do produto junto ao Ministério da Saúde (ANVISA). Apresentar bula autenticada que comprove o cumprimento do descritivo.

A composição do **BOLSA PARA ESTOMA INTESTINAL 2 PEÇAS 70MM - CONVATEC** para é compatível com a solicitada no edital:

- Está em conformidade com o descritivo atendendo plenamente o solicitado

CONCLUSÃO: Produto **CLASSIFICADO** por estar em conformidade com o edital.

ITEM 27

A empresa **SÓ QUÍMICA LABORATÓRIOS LTDA** ofertou o produto **BOLSA PARA ESTOMA INTESTINAL 2 PEÇAS 70MM - CONVATEC** a qual podemos comprovar que:

SOLICITADO NO EDITAL: KIT PLACA E BOLSA PARA ESTOMA INTESTINAL 2 PEÇAS 70MM. COLOSTOMIA/ILEOSTOMIA drenável, drenável, com plástico macio, atóxico e hipoalergênico, opaca, com oito pontos de fixação, barreira moldável, permitindo que a abertura para encaixe do estoma seja moldada com os dedos. Placa de resina com 3 camadas, superior e inferior (contato com a pele) composta por gelatina, pectina, carboximetilcelulose e polímeros elastoméricos, e a camada média por película de polietileno impermeável a líquidos. Placa moldável que adapta a estomas regulares e irregulares, **com diâmetro de 45-56mm** sem utilização de acessórios para recorte, **flange 70 mm** com pressão abdominal e 8 pontos de fixação, composta de 2 peças para estoma intestinal. **Caixa com 10 unidades.** Apresentar junto a proposta: - bula autenticada ou ficha técnica que comprove o cumprimento do descritivo e uma amostra em embalagem original e lacrada. A amostra deverá vir acompanhada de declaração do fabricante ou da detentora do Registro do produto junto ao Ministério da Saúde (ANVISA) subscrita por seu representante legal confirmando estar a proponente autorizada a comercializar o item.

A composição do **BOLSA PARA ESTOMA INTESTINAL 2 PEÇAS 70MM - CONVATEC** para é compatível com a solicitada no edital:

- Está em conformidade com o descritivo atendendo plenamente o solicitado

gal

ASL



PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDINO DE CAMPOS
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE

Praça Monsenhor Francisco Van Der Maas N.º 150 - Bairro: Centro
Fone/Fax: (14) 3346-3388 / 3346-3360 / 3346-1626
E-mail: saude@bernardinodecampos.sp.gov.br



CONCLUSÃO: Produto **CLASSIFICADO** por estar em conformidade com o edital.

ITEM 28


A empresa **NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR S.A** ofertou o produto **MAGIC3 MASC SILIC HIDROF 12FR**: a qual podemos comprovar que está em desacordo com a solicitação do edital, demonstraremos abaixo:

SOLICITADO NO EDITAL: Cateter uretral hidrofílico, pronto para o uso, Masculino, calibre CH12; Cateter composto por tubo confeccionado com aditivos hidrofílicos em sua composição, a base de elastômero POBE, sem qualquer revestimento hidrofílico de PVP (Polivinilpirrolidona) ou outro material. Que não seja pegajoso e/ou aderente quando seco. Flexível com orifícios polidos e conector plástico. Contendo sachê de água estéril visível na embalagem, e manga de proteção para o cateterismo preciso e sem toque. Embalagem segura e transparente, não metálica, que não ofereça riscos de ferimentos ao usuário/profissional, que promova barreira antimicrobiana e abertura asséptica, com orifício de suporte para o dedo. Produto esterilizado por óxido de etileno e de uso único. Caixa com 30 unidades. Ter Registro do produto junto ao Ministério da Saúde (ANVISA).

Apresentar junto a proposta: - bula autenticada ou ficha técnica que comprove o cumprimento do descritivo.

A composição do MAGIC 3 GO é divergente com a solicitada no edital:

- Não possui propriedade hidrofílica incorporada, mas sim é um cateter de silicone;

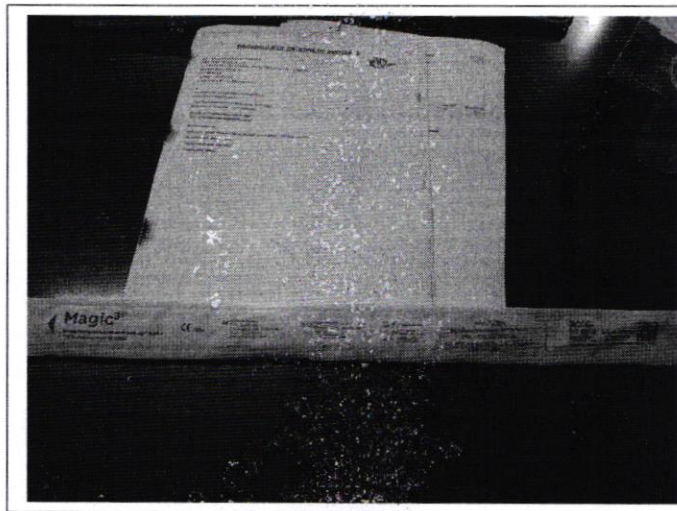

CONCLUSÃO:

- **DESCCLASSIFICADO**, produto não apresenta a formulação solicitado conforme descritivo do edital;
- **DESCCLASSIFICADO**, por não apresentar o produto em embalagem original e lacrada, entendemos como embalagem original e lacrada o produto dentro de sua caixa inviolada e com a bula do produto.

Gal




PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDINO DE CAMPOS
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE



Praça Monsenhor Francisco Van Der Maas N.º 150 - Bairro: Centro
Fone/Fax: (14) 3346-3388 / 3346-3360 / 3346-1626
E-mail: saude@bernardinodecampos.sp.gov.br

A empresa CIRURGICA UNIÃO LTDA, apresentou amostra de um produto (imagem abaixo), porém não conseguimos identificar para qual item o mesmo pertence, uma vez que ele não veio com nenhuma identificação.

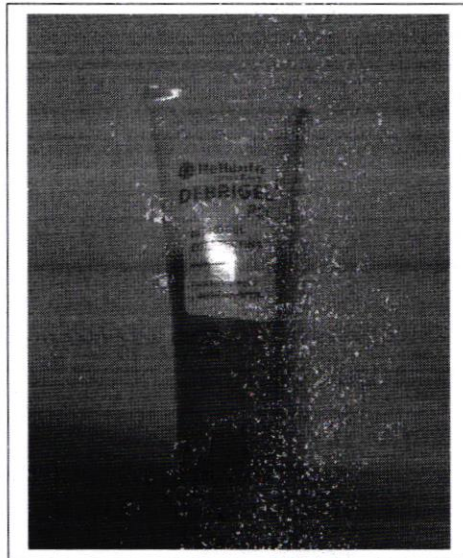


Senhor(a) pregoeiro(a), após todas as informações e avaliações apresentadas, esta comissão pede que seja dado andamento ao processo o mais breve possível para que possamos chegar a conclusão do mesmo.


Nestes termos;
Pedimos e aguardamos deferimento.

Bernardino de Campos, 28 de setembro de 2022.


Comissão avaliadora:



Silvia Helena Martins Tolini
Enfermeira COREN/SP 307.086



Valquiria Cristina de Moraes
Enfermeira COREN/SP 323.140



Fernanda Cristina de Souza
Enfermeira COREN/SP 652.216

